



新規測定




開く



オプション

コマンド待機中

比率表示へ

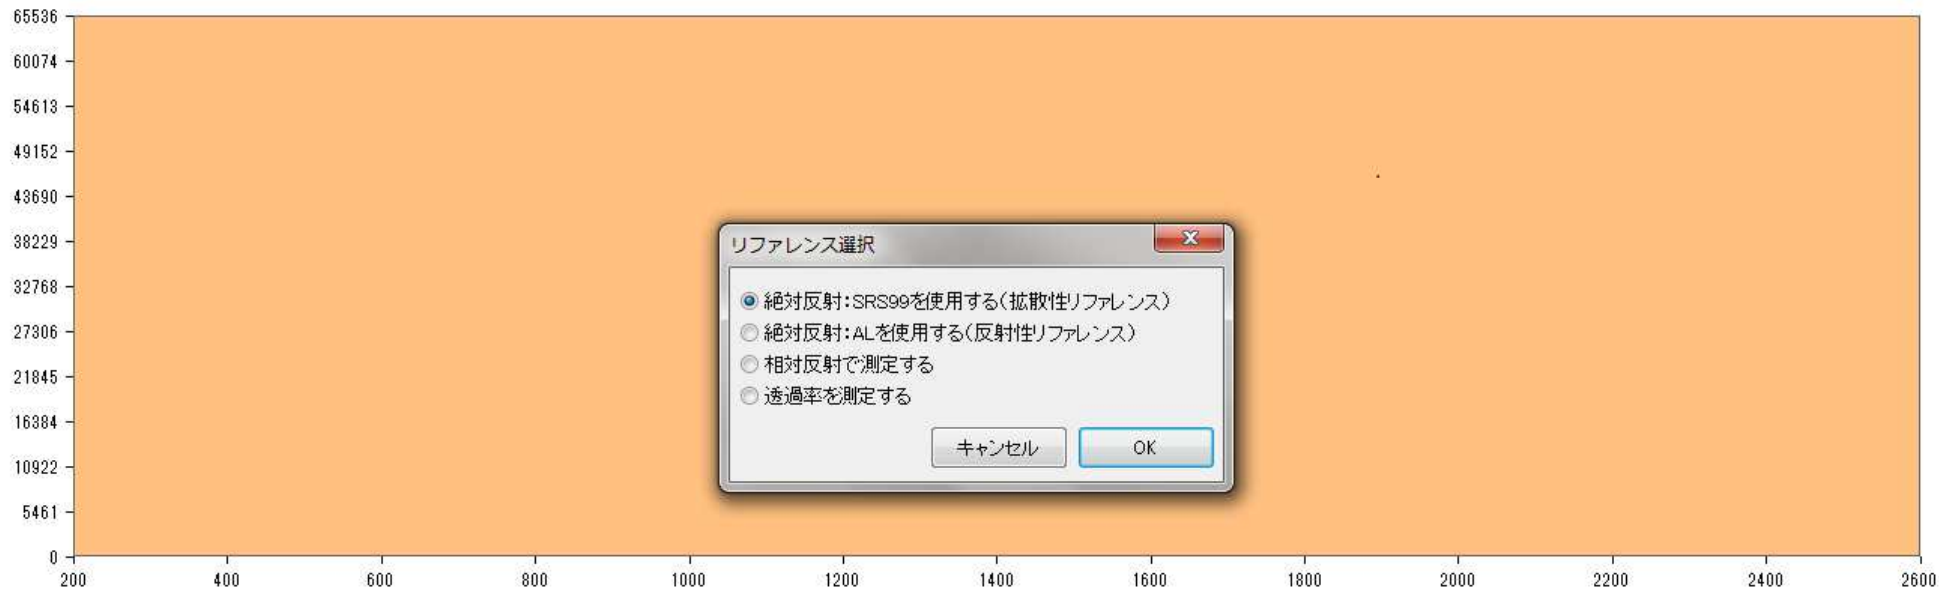

リファレンス選択

- 絶対反射:SRS99を使用する(拡散性リファレンス)
- 絶対反射:ALを使用する(反射性リファレンス)
- 相対反射で測定する
- 透過率を測定する

キャンセル OK


番号 コメント

α s



コマンド待機中


データ表示へ 再描画



番号	コメント	αs
リファレンス		

コマンド待機中


比率表示へ 再描画



番号	コメント	αs
リファレンス		-

コマンド待機中


データ表示へ 再描画



番号	コメント	α s
リファレンス		
1		0.01
2	50%	0.56
3	10%	0.91

コマンド待機中

比率表示へ 再描画



番号	コメント	α s
リファレンス		-
1		0.01
2	50%	0.56
3	10%	0.91